




FUNC を押しながら PROG キー




50°Cに設定しますキーで変更する




設定終了です




SEG1は設定変更しない




ENT キーで決定

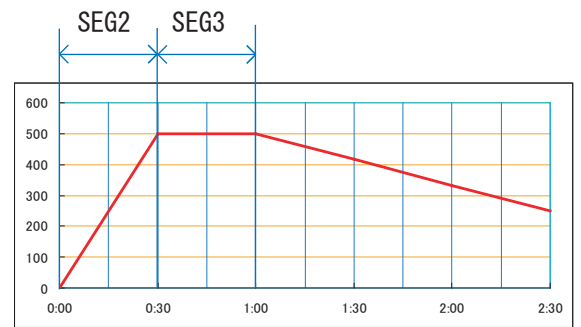


昇温プログラムのセグメントごとにEV1を設定してください。




SEG2 のオーバーヒートの設定をします
下キーをおしてください



SEG2 が50になりました
SEG3 にしてください。



EV1のランプ点灯ご設定値を入力
します(0にはしないでください)



SEG3も同様に設定してください